面积百分比报告

数据路径 : D:\MassHunter\Data\F26\2023.11\
数据文件 : A44064-2311250052-299066-01.D
采集 : 29 Nov 2023 19:27
操作者 :
样品 : Sample 8
其他 :
ALS 样品瓶 : 8 样品乘积因子 : 1

积分参数 : autoint1.e
积分器 : 化学工作站


方法 : D:\MassHunter\Data\Method\ALS-BP130-0.1uL.M
标题 :


信号: TIC: A44064-2311250052-299066-01.D\data.ms

峰 #	保留时间 分钟	起始 扫描	峰顶 扫描	截止 扫描	峰 类型	峰高 峰高	修正 面积	修正 % 最大值	% 总量
1	5.020	320	328	337	BV	893413	12851662	0.70%	0.694%
2	5.570	399	421	463	BB 4	51528880	1828493144	100.00%	98.726%
3	6.201	519	528	547	M2	171519	4105900	0.22%	0.222%
4	7.047	666	671	695	M4	70648	2185403	0.12%	0.118%
5	7.385	704	728	742	M2	144269	4460925	0.24%	0.241%


修正后的面积和: 1852097034

ALS-BP130-0.1uL.M 2023-11-30 周四 16:33:34

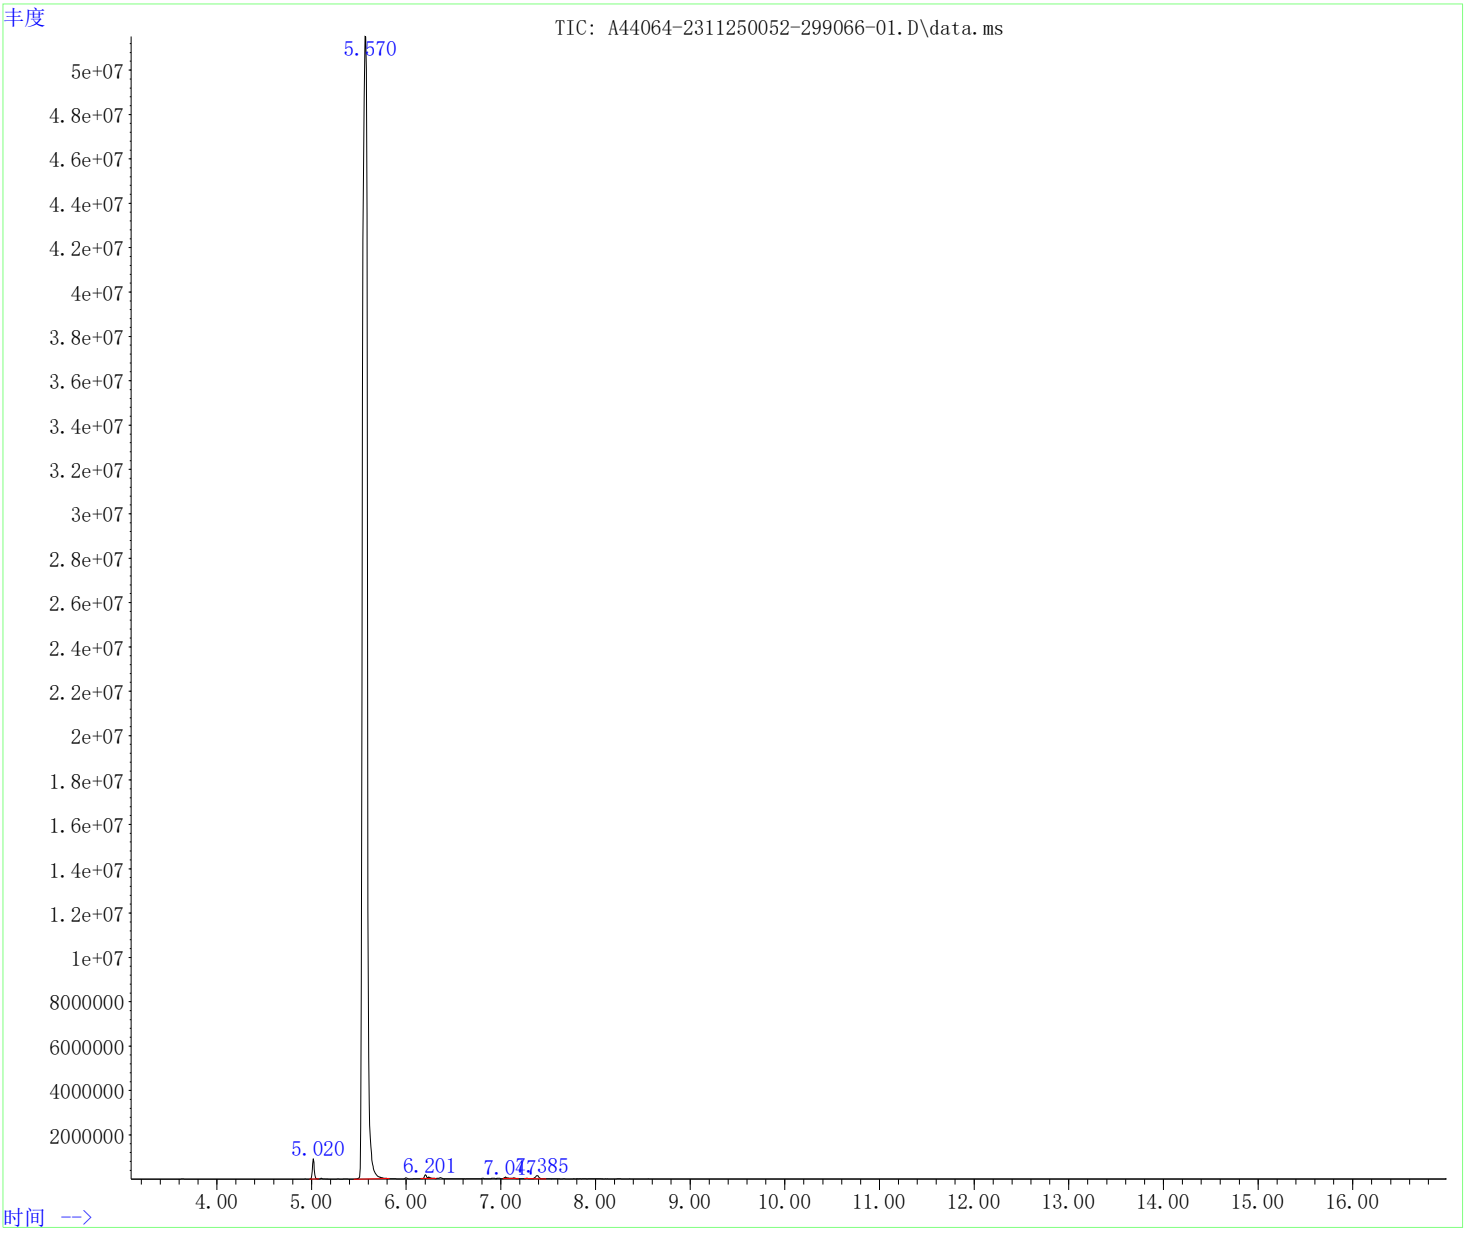


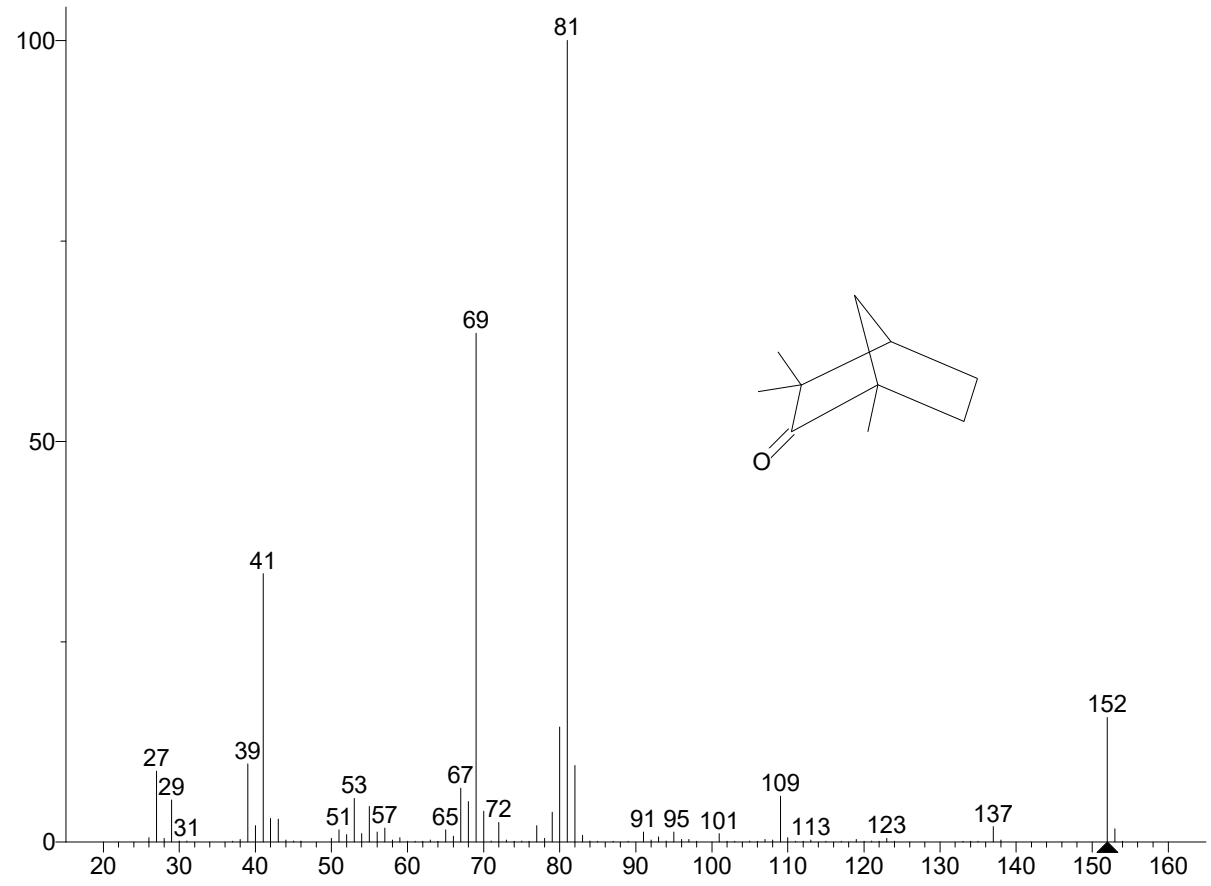


(mainlib) D-Fenchone

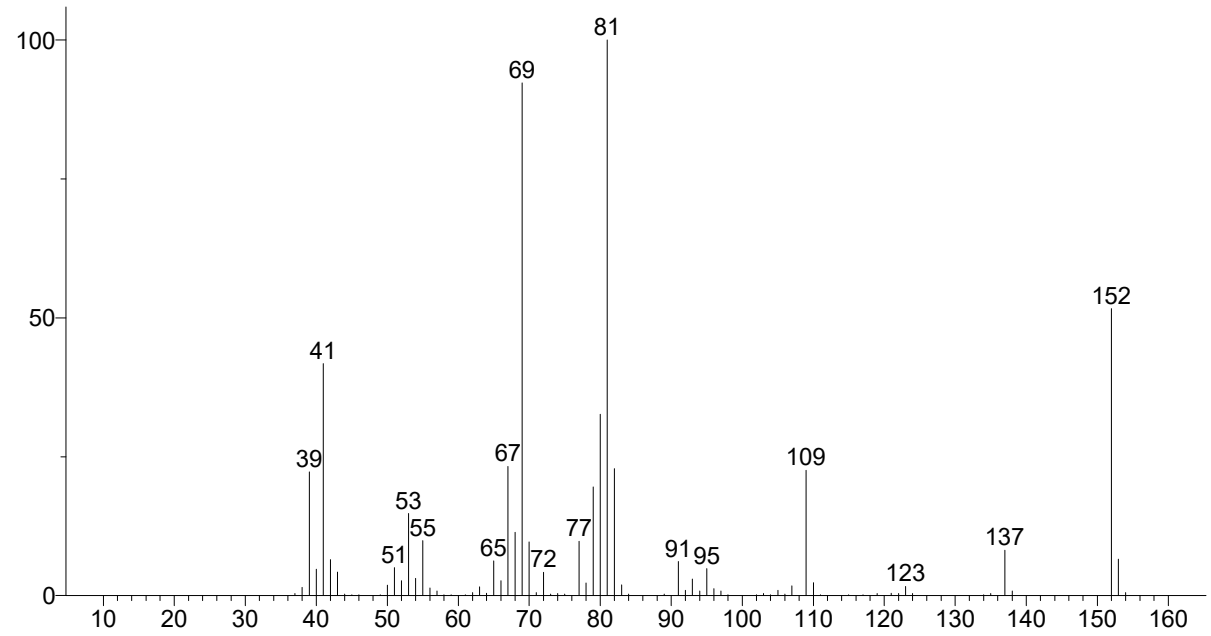


(Text File) 420 (5.566): A44064-2311250052-299066-01.D\data.ms

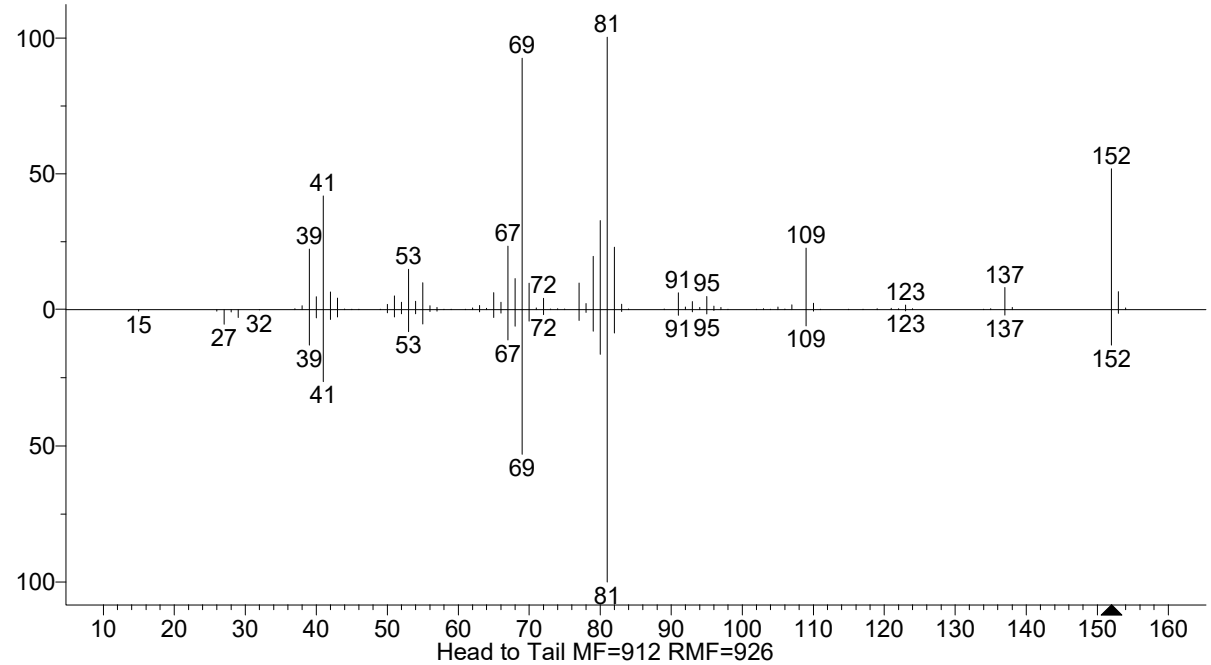


Head to Tail MF=912 RMF=926

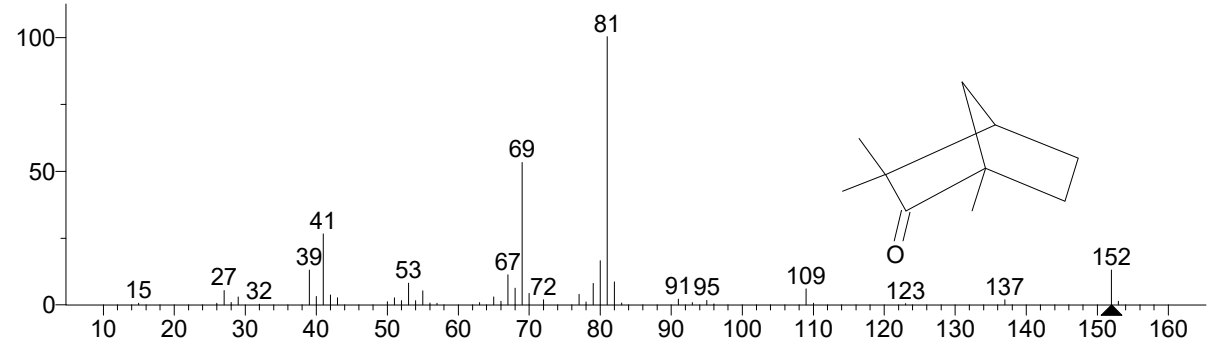


(mainlib) Fenchone

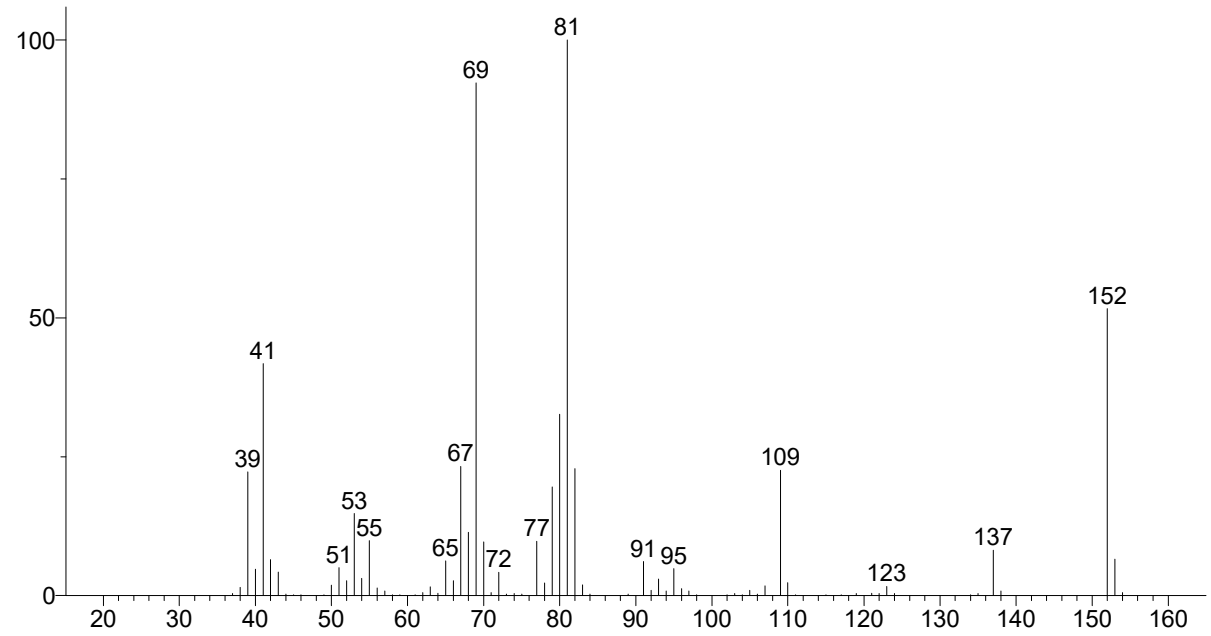


(Text File) 420 (5.566): A44064-2311250052-299066-01.D\data.ms

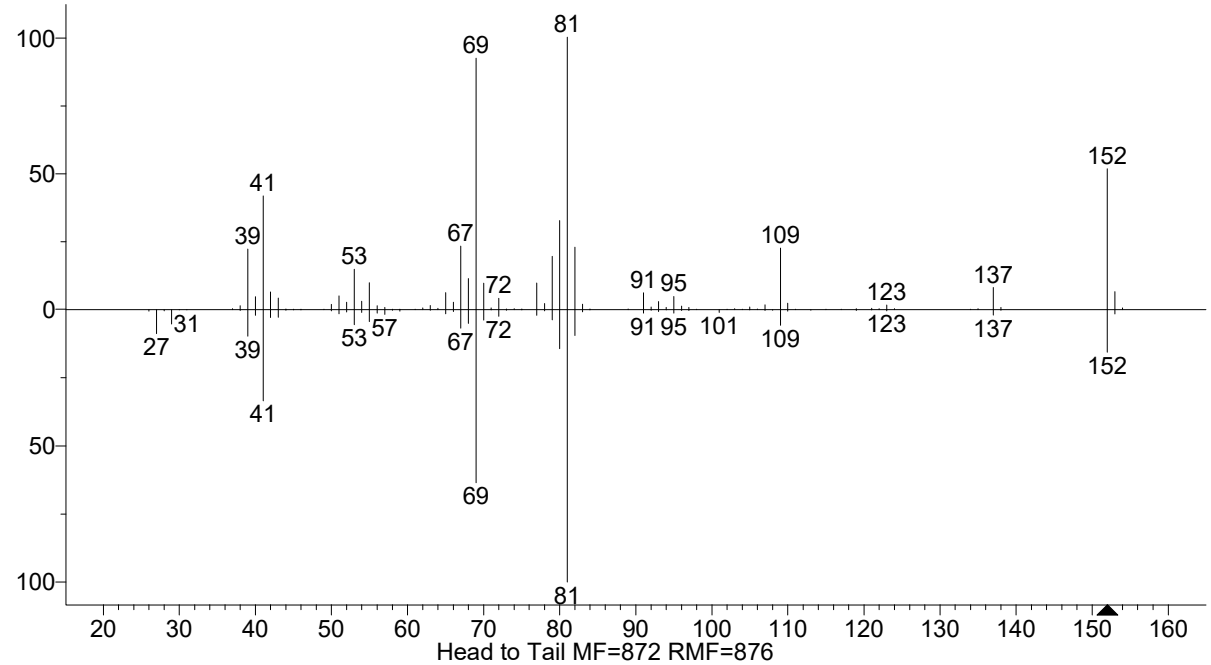


Head to Tail MF=872 RMF=876

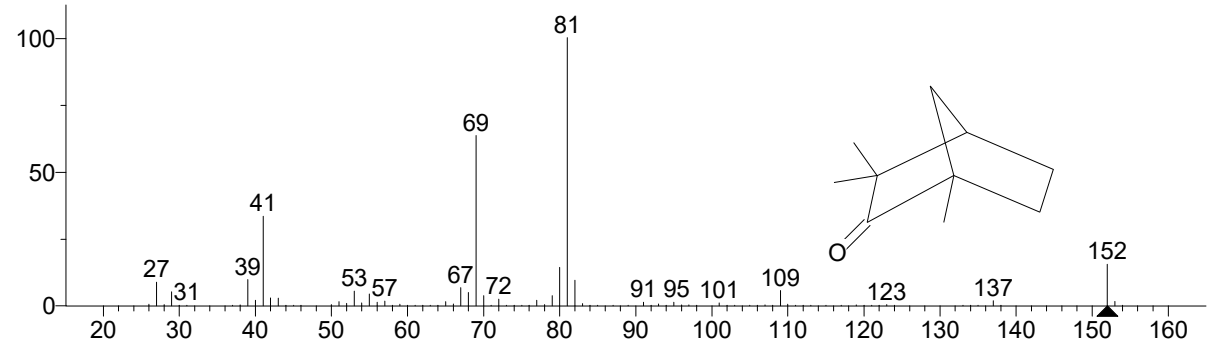


(mainlib) D-Fenchone

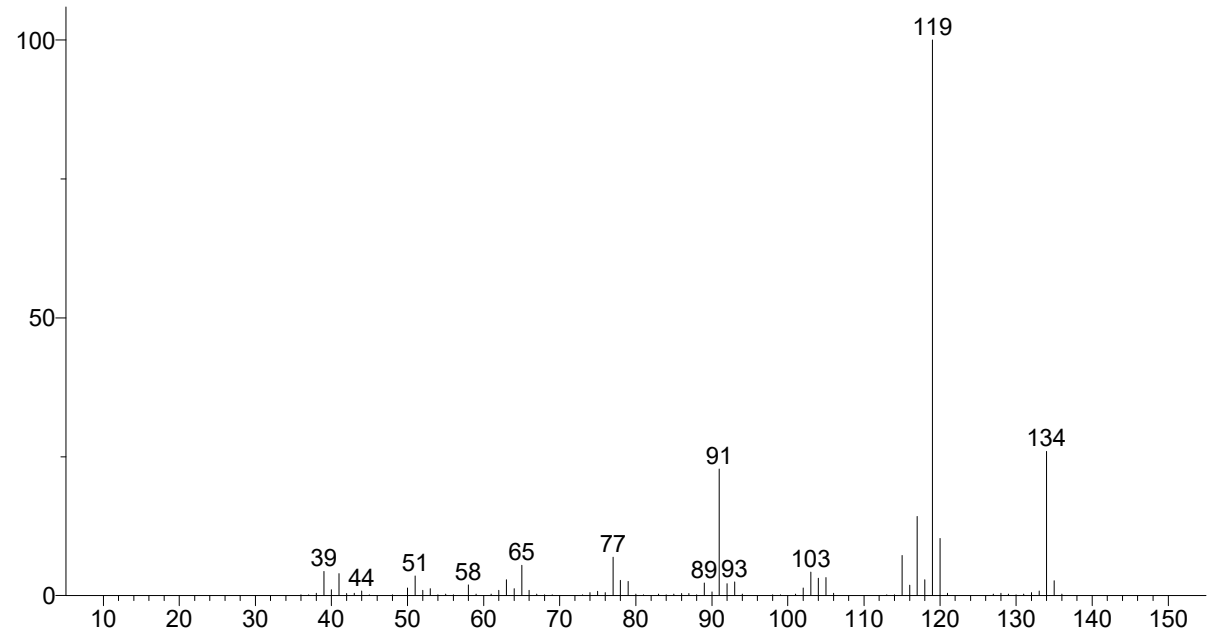


(Text File) 327 (5.017): A44064-2311250052-299066-01.D\data.ms

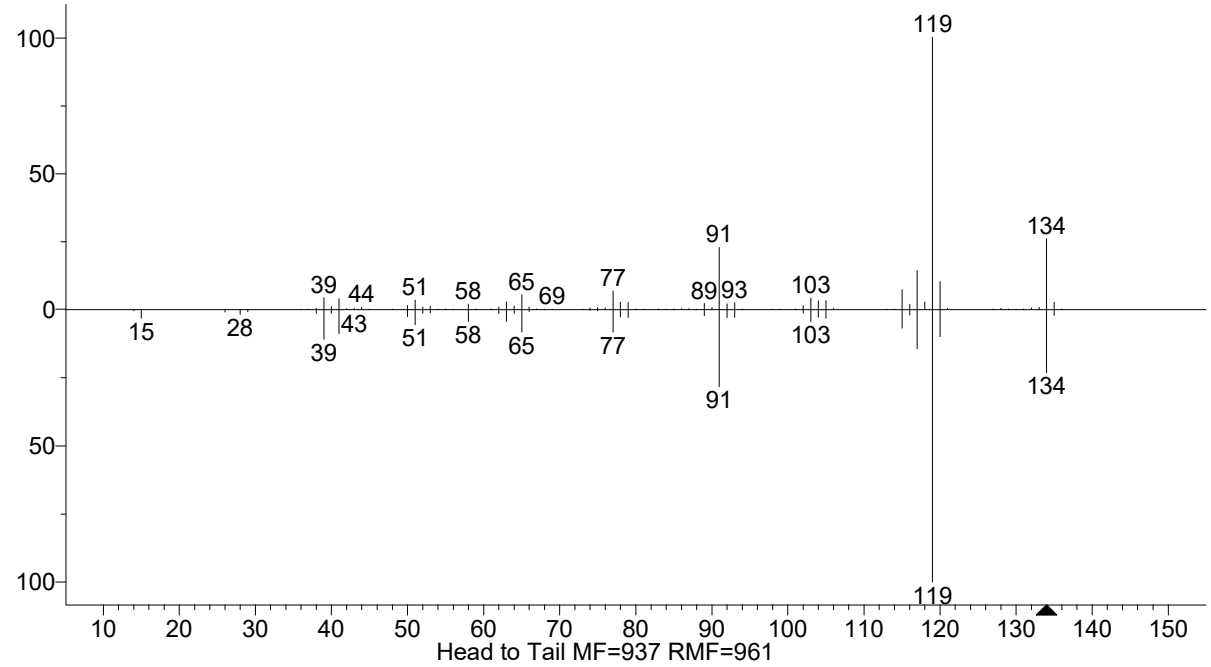


Head to Tail MF=937 RMF=961

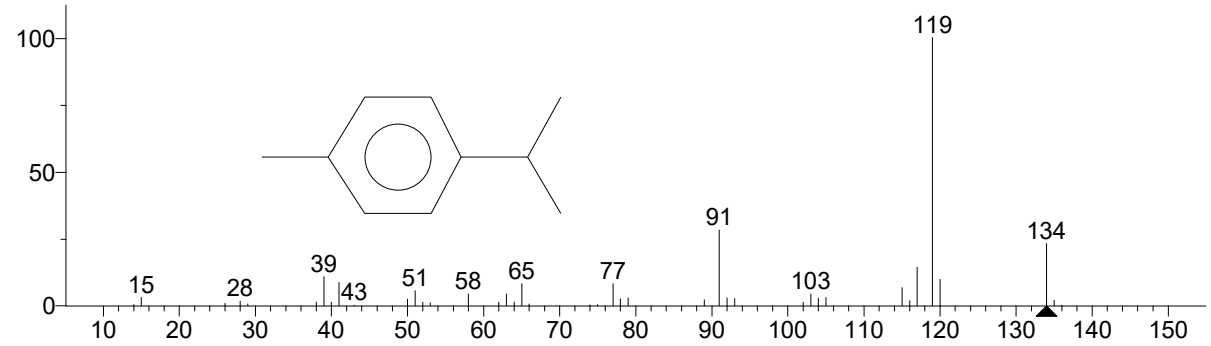


(replib) p-Cymene

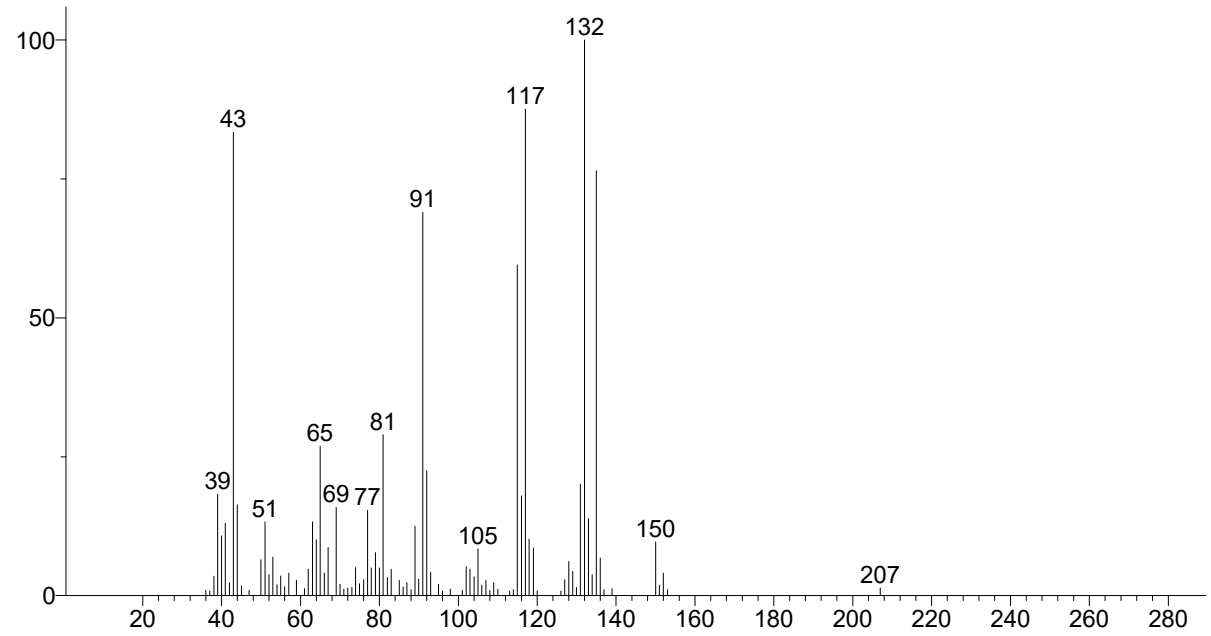


(Text File) 528 (6.204):A44064-2311250052-299066-01.D\data.ms

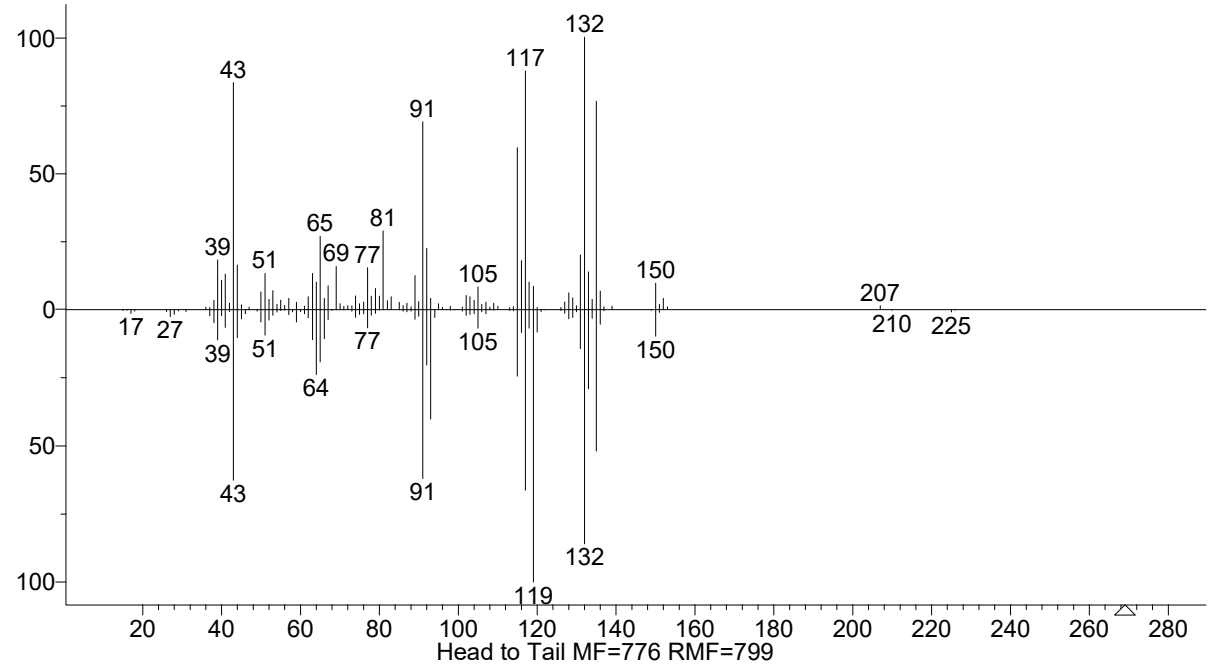


Head to Tail MF=776 RMF=799

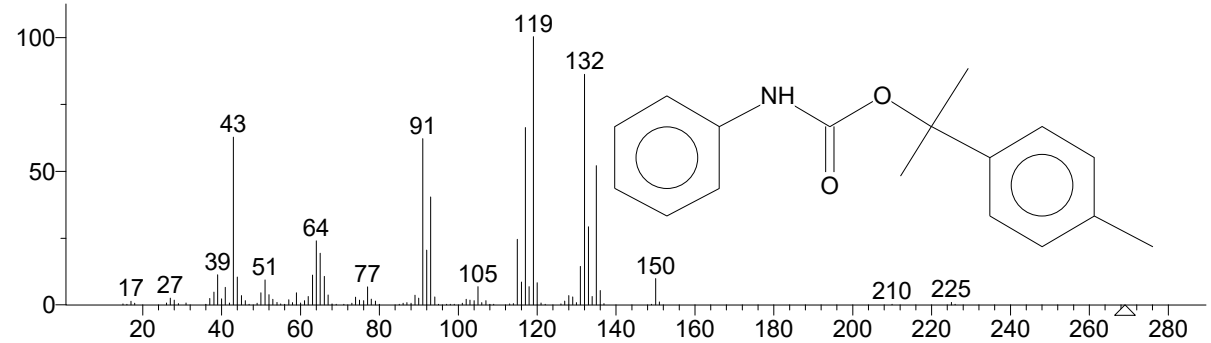


(mainlib) Alpha,alpha,4-trimethylbenzyl carbanilate

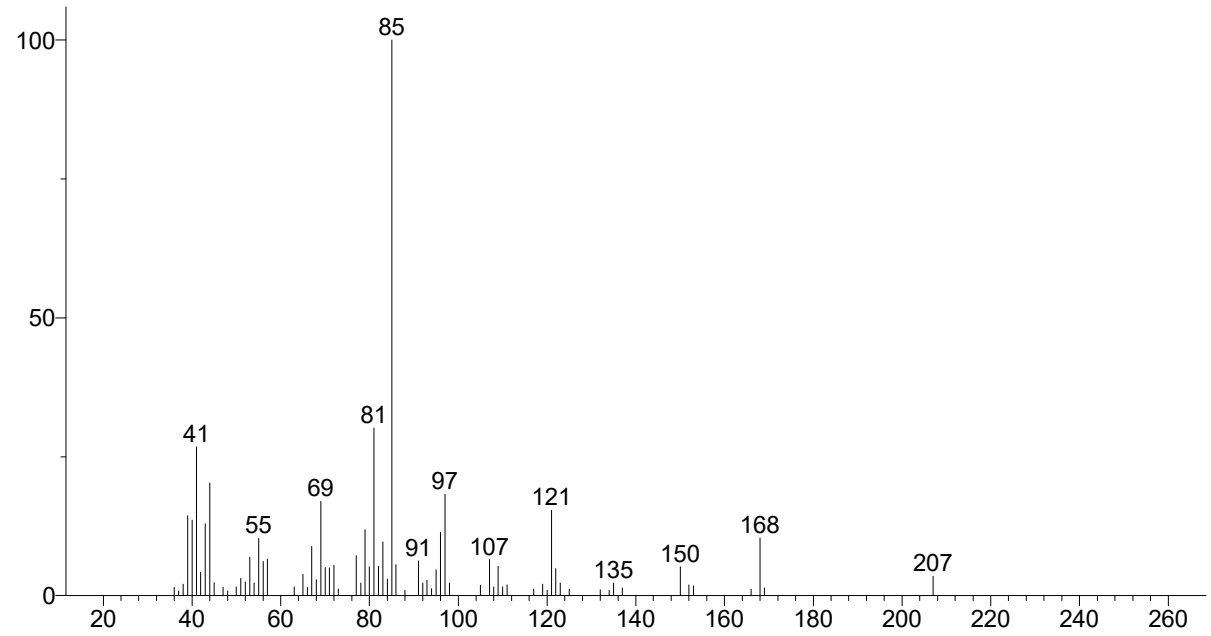


(Text File) 672 (7.054): A44064-2311250052-299066-01.D\data.ms

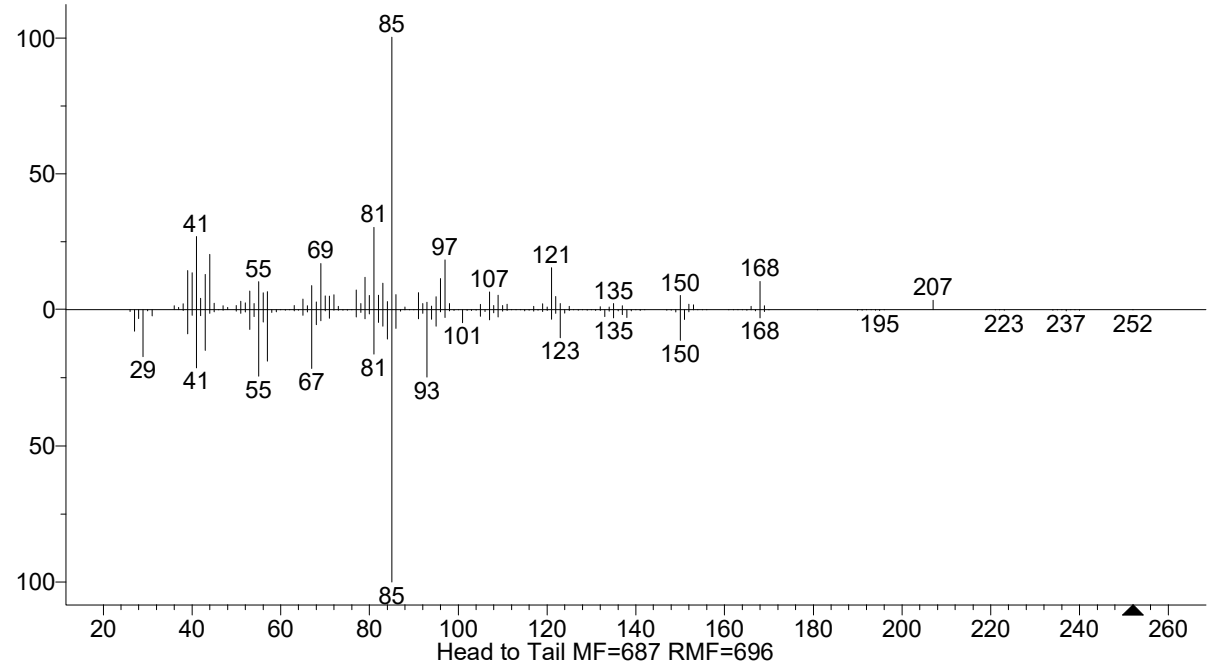


Head to Tail MF=687 RMF=696

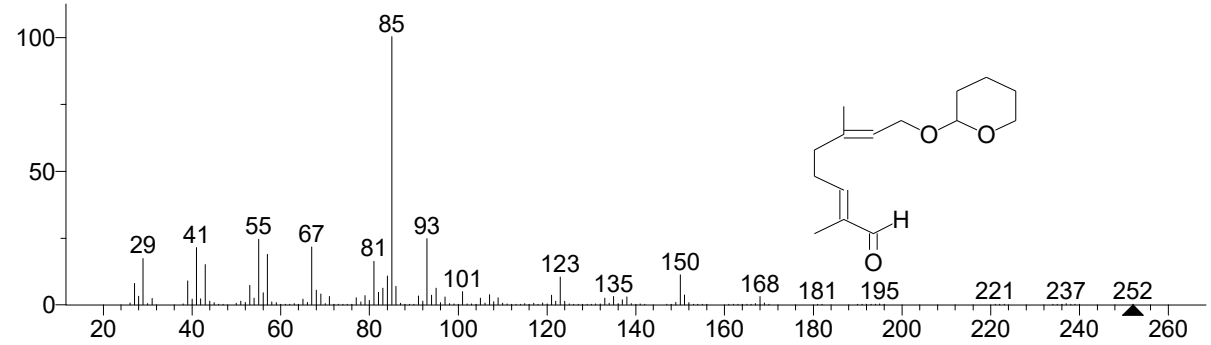


(mainlib) 2,6-Octadienal, 2,6-dimethyl-8-(tetrahydro-2H-2-pyranyloxy)

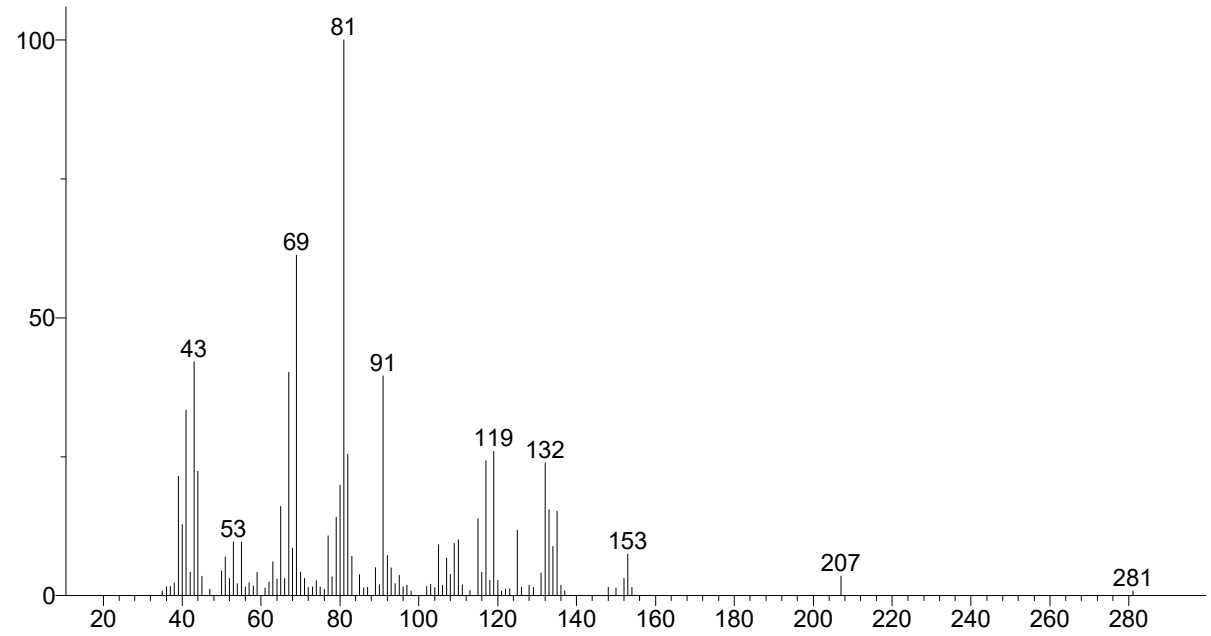

(Text File) 727 (7.379): A44064-2311250052-299066-01.D\data.ms

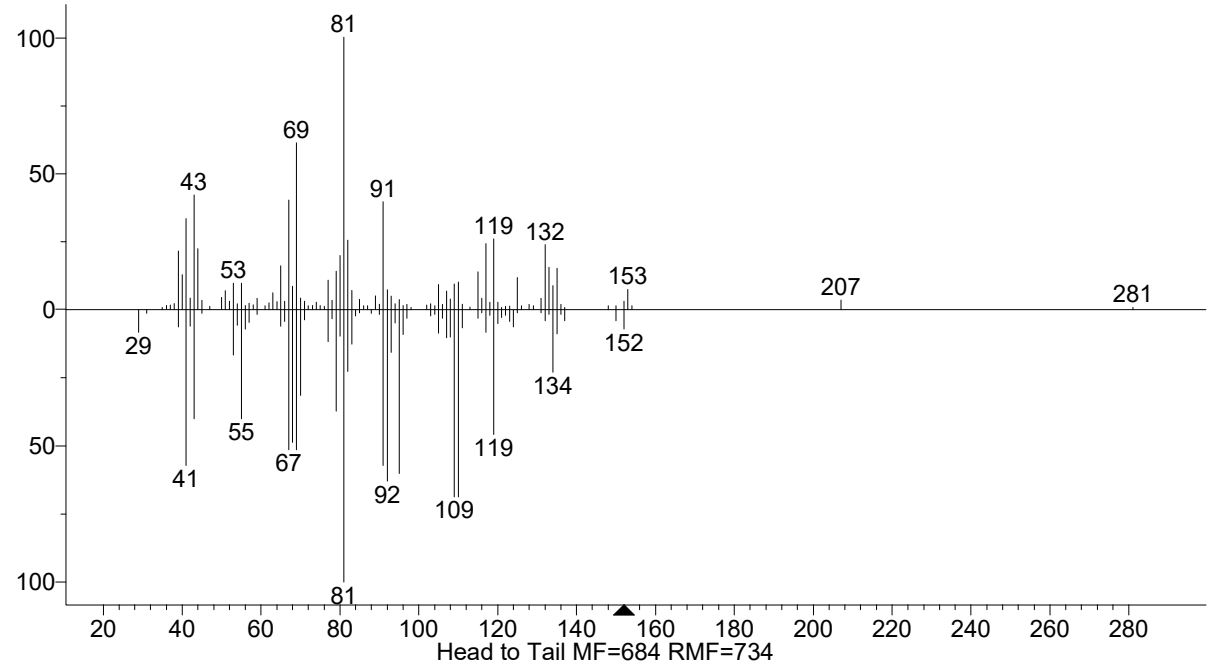

Head to Tail MF=684 RMF=734

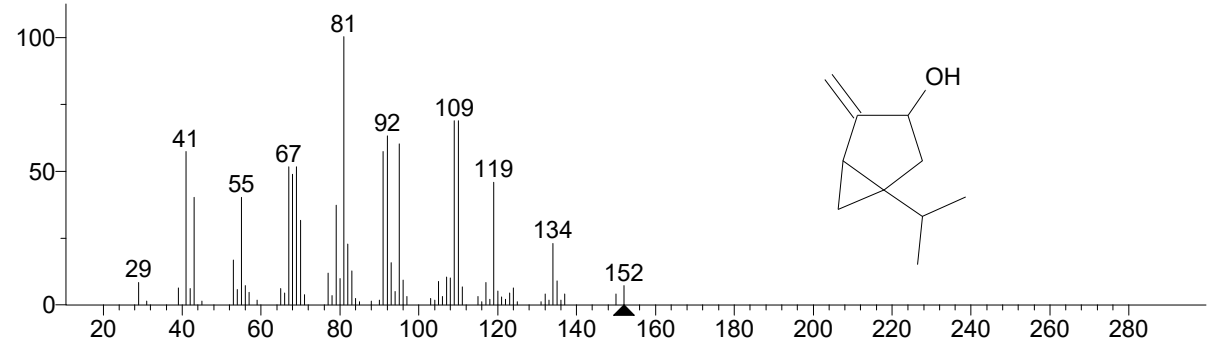

(replib) Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-, [1S-(1α,3β,5α)]-

仪器控制参数：　GCMS

D:\MassHunter\Data\Method\ALS-BP190-0.1uL.M
Wed Nov 29 19:45:51 2023

控制信息

进样口	: GC
进样方式	: GC ALS
进样位置：	前
质谱仪	: 启用

没有为此方法分配样品准备方法.

GC

GC 摘要	
运行时间	17 min
后运行时间	1 min

柱箱	
温度	
设定值	开启
（初始值）	70 ° C
保持时间	0 min
后运行	200 ° C
程序	
#1 速率	20 ° C/min
#1 值	210 ° C
#1 保持时间	10 min
平衡时间	1 min
最高温度	325 ° C
最高温度覆盖	禁用
低速风扇	禁用

ALS

前进样器	
进样针规格	10 µL
进样量	0.1 µL
溶剂 A 清洗（前进样）	5
溶剂 A 清洗（后进样）	5
溶剂 A 体积	8 µL
溶剂 B 清洗（前进样）	5
溶剂 B 清洗（后进样）	5
溶剂 B 体积	8 µL
样品清洗	4
样品清洗量	8 µL
样品抽吸次数	4
驻留时间（前进样）	0 min
驻留时间（后进样）	0 min
溶剂清洗抽吸速度	300 µL/min
溶剂清洗排出速度	3000 µL/min
样品清洗抽吸速度	300 µL/min
样品清洗排出速度	3000 µL/min
进样排出速度	300 µL/min
粘度延迟	0 秒

采样深度	禁用
进样类型	标准
L1 气隙	0.2 µL
溶剂清洗模式	A, B
样品重叠	
模式	未启用样品重叠
ALS 错误	暂停以进行用户交互
前 SS 进样口 He	
模式	分流
加热器	开启 210 ° C
压力	开启 13.489 psi
总流量	开启 163.8 mL/min
隔垫吹扫流量	开启 3 mL/min
预运行流量测试	关闭
载气节省	开启 20 mL/min 后 2 min
分流比	200 :1
分流流量	160 mL/min
衬管	未选择衬管。
色谱柱	
色谱柱 #1	
流量	
设定值	开启
（初始值）	0.8 mL/min
后运行	1.322 mL/min
色谱柱信息	Agilent 19091S-433UI
说明	HP-5ms Ultra Inert
温度范围	-60 ° C—325 ° C (350 ° C)
尺寸	30 m x 250 µm x 0.25 µm（未校准）
色谱柱锁定	解锁
进样	前 SS 进样口 He
出样	PSD 1
（初始值）	70 ° C
压力	13.489 psi
流量	0.8 mL/min
平均线速度	19.387 cm/sec
保持时间	2.5791 min
控制模式	恒定流量
色谱柱 #2	
流量	
设定值	开启
（初始值）	1 mL/min
后运行	1.9144 mL/min
温度范围	-60 ° C—325 ° C (350 ° C)
尺寸	2.5 m x 150 µm x 0 µm（未校准）
色谱柱锁定	解锁
进样	PSD 1 He
出样	MSD
（初始值）	70 ° C
压力	4.0764 psi
流量	1 mL/min
平均线速度	127.47 cm/sec
保持时间	0.032688 min
控制模式	恒定流量

色谱柱出口压力	0 psi
检测器评估	
执行检测器评估测试	关闭
选定的信号	未选择信号
校验样品	无
MSD 传输线	
温度	
设定值	开启
（初始值）	280 ° C
PSD 1	
PSD 吹扫	开启 0 mL/min
PSD 1 He	提供色谱柱 2
信号	
信号 #1:	
说明	无
信号 #2:	
说明	无
信号 #3:	
说明	无
信号 #4:	
说明	无
信号 #5:	
说明	无
信号 #6:	
说明	无
信号 #7:	
说明	无
信号 #8:	
说明	无

MS 信息
-- ----------

常规信息
------- ----------

采集模式 : 扫描
溶剂延迟 (min) : 3
调谐文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\5977\atune.u
EM 设置模式 增益 : 1.000000

标准或快速扫描 : 标准扫描
痕量离子检测 : 关闭
运行时间 (若仅 MS) : 10 min

[扫描参数]
开始时间 : 3
低质量 : 33
高质量 : 550
阈值 : 150
A/D 样品： : 4

[MS 区域]

MS 离子源 : 230 C 最大值 250 C
MS 四极杆 : 150 C maximum 200 C

定时事件
----- ------
事件数= 0

结束 MS 采集参数

调谐参数， SN: US2143R043

痕量离子检测已关闭。

34.593	:	发射电流
70.007	:	能量
34.899	:	推斥极
90.331	:	离子聚焦
17.627	:	入口透镜
1104.376	:	EM 电压
1192.8	:	实际 EMV
1.00	:	增益因子
3196.000	:	AMU 增益
137.313	:	AMU 补偿
1.000	:	灯丝
0.000	:	DC 极性
14.443	:	入镜补偿
0.000	:	离子体
0.000	:	出口透镜
386.000	:	质量增益
-25.000	:	质量补偿

调谐参数末尾

仪器控制参数末尾
